


Silk'n®

Titan MultiPlatform

H2502

- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- ES MANUAL DEL USUARIO



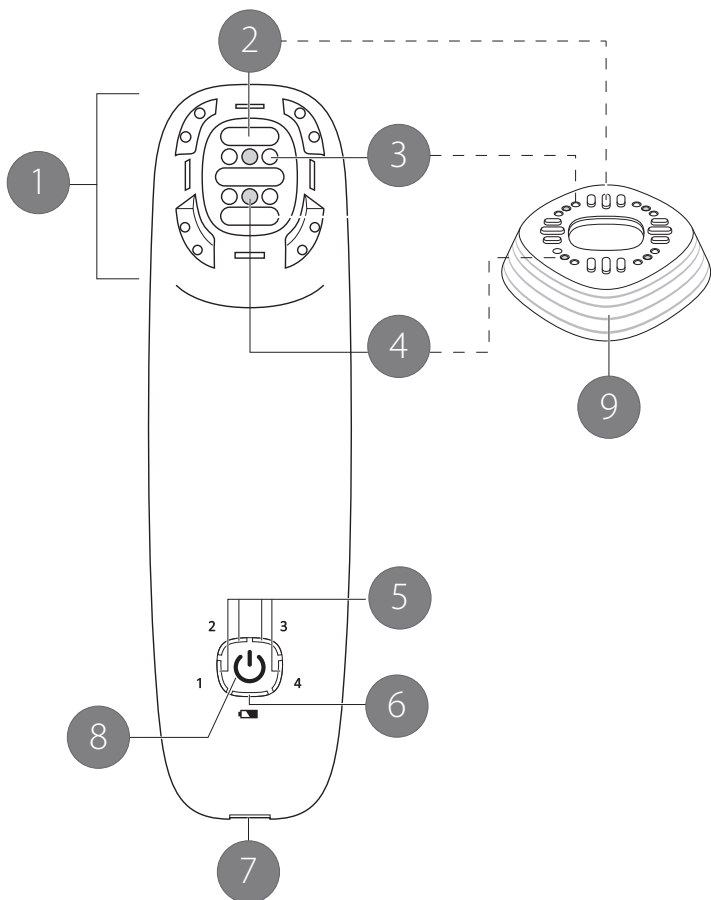

Skin types / Types de peau / Tipos de piel

✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light, pale white	White fair	Medium white to olive	Olive moderate brown	Brown, dark brown	Black, very dark brown
Peau très claire, pâle	Peau claire	Peau claire à mate	Peau brune, mate	Peau brune, foncée	Peau très foncée ou noire
Clara, blanca, pálida	Blanca, clara	Blanca media a olivácea	Marrón moderada a olivácea	Marrón, marrón oscuro	Negro, marrón muy oscuro

Table of contents

1. Warnings	2
2. Contraindications	3
3. Safety features	4
4. Get to know your device	4
4.1 Device description	4
4.2 Intended use	5
4.3 Package contents	5
4.4 Device parts	5
4.5 Device controls & settings	5
4.6 Charging the battery	6
5. Treatments	7
5.1 Treatment areas	7
5.2 Treatment plan	7
5.3 What to expect	8
5.4 Possible side effects	8
6. Get started!	8
6.1 Treatment steps for use on smaller areas	9
6.2 Treatment steps for use on larger areas	10
7. Cleaning, maintenance & storage	10
8. Troubleshooting	11
9. Customer service	11
10. Consumables	11
11. Warranty	12
12. Disposal	12
13. Labeling	13
14. Signs & symbols	13
15. Specifications	14
16. Output power curves	15
17. EMC Technical results	17
18. Legal notice	18

1. Warnings



EN

This device is powerful and should be used with special attention to safety. Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions, and follow them strictly. We recommend you refamiliarise yourself with the instructions before each treatment.

- Always ensure that your hands are dry before operating the device, touching the plug, or connecting the charging cradle to the mains supply.
- Do not place or store the wall adapter where it can fall, or be pulled into any liquid.
- For the purpose of recharging the battery, only use the wall adapter provided with this device.
- Do not use the wall adapter if it has fallen into liquid.
- Disconnect the device from the mains supply after charging the battery.
- Keep the device, all parts and accessories away from heated surfaces.
- Never leave the device unattended when plugged into the mains supply.
- Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.
- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if they are damaged in any way, do not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device, and contact customer service.
- Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- This device contains batteries that are non-replaceable.

- ⦿ This unit has been designed and tested to meet the requirements of electromagnetic, electrostatic, and radio frequency interference standards. However, the possibility of electromagnetic or other interference may still exist. Relocating the device may help to eliminate interference.
- ⦿ Do not dispose of the device or the battery with household waste! The law requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
- ⦿ Dispose of the battery safely.
- ⦿ If the product reaches its end of life, the battery must be removed before disposal (see section [12. Disposal](#)).

2. Contraindications

The device must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

Do not use if you:

- ⦿ have a pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- ⦿ suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- ⦿ have a history of skin cancer, or current condition of any other type of cancer, or pre-malignant moles.
- ⦿ have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- ⦿ have an impaired immune system due to immuno-suppressive diseases such as AIDS and HIV, or use immunosuppressive medications.
- ⦿ have used Isotretinoin (Accutane®) within 6 months prior to treatment.
- ⦿ have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- ⦿ suffer from epilepsy.
- ⦿ are pregnant or nursing.

Do not use on areas that have:

- ⦿ a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- ⦿ any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, rashes, open lacerations, abrasions, or lesions.
- ⦿ traumatized or injured skin.

- ⦿ had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.
- ⦿ had any surgery within 3 months prior to treatment.
- ⦿ tattoos.
- ⦿ long or thick hair. Use of the device may result in light bruising.



Consult your physician if you have:

- ⦿ used steroids within 3 months prior to treatment.
- ⦿ couperose or rosacea.
- ⦿ a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area. If so, you may treat only following a prophylactic regime.
- ⦿ used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- ⦿ a history of skin disorders, keloids, abnormal wound healing, as well as very dry and fragile skin.
- ⦿ any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

3. Safety features

The device has these features to protect your skin from overheating.

- ⦿ **Thermal sensor and heat stabilizer:** These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- ⦿ **Movement sensor:** Enables the device to generate RF only when you are moving the device across your skin.

4. Get to know your device

4.1 Device description

The device is a face treatment device which utilizes Home Technology™. The device combines several kinds of energy: Low Level Laser Therapy (LLLT), Infrared and Bi-Polar Radio Frequency energy (Bi-Polar RF) that treat the upper layer, dermis and deep sub-dermal fat to improve the skin's appearance and reduce wrinkles.

The device includes a treatment surface with 3 electrodes and a control button with 5 surrounding indicator lights. It has a rechargeable battery for cordless use, as well as a wall adapter for connection to the mains supply.

4.2 Intended use

The device is an over-the-counter home use device intended for the non-invasive treatment of mild to moderate facial wrinkles for adult women who have Fitzpatrick skin types I-IV (see the skin color chart at the front of the user manual).

The device is for self-treatment at home and is not suitable for commercial purposes. Do not use for any purpose other than as described in this user manual.

4.3 Package contents



- Your Silk'n device
- RF attachment
- Silk'n Slider Gel
- AC/DC wall adapter
- User manual


4.4 Device parts

Refer to the diagram on page (i) at the front of this manual to see the location of each feature.

- Treatment surface (#1)
- Electrodes (#2)
- LED lights (#3)
- Infrared lights (#4)
- 4 energy level indicator lights (#5)
- Battery / attachment indicator light (#6)
- Wall adapter socket (#7)
- Control button (#8)
- RF attachment (#9)

4.5 Device controls & settings


Button	Action	Function / Mode
Control button (#8) 	Long press x 1	Starts the device. Energy level 1 - 1 light on
	Short press x 1	Energy level 2 - 2 lights on
	Short press x 2	Energy level 3 - 3 lights on
	Short press x 3	Energy level 4 - 4 lights on
	Short press x 4	Goes back to level 1
	Long press	Goes back to standby mode
Energy level indicator lights (#5) 	Shows the energy level selected.	There is one light for each energy level. Level 1 is the lowest energy level, and level 4 is the highest.

Button	Action	Function / Mode
Battery/ attachment indicator light (#6) 	Orange - blinks Green - constant Orange - blinks	Device charging Device charged Low charge in battery (cordless)

4.6 Charging the battery

1. Charge the device before first use.
2. Place the wall adapter cable into the device, then connect the wall adapter to the mains supply. The battery/attachment indicator light **(#6)** will blink orange.
3. Position the wall adapter so that the mains plug is disconnected easily.

i The battery icon does not change color.

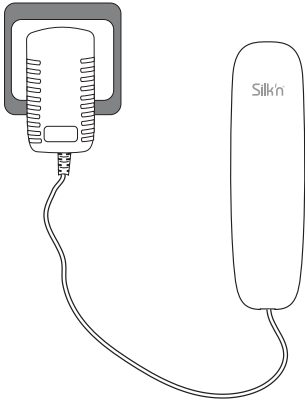


i You can use the device when it is connected to the mains supply. Note that the battery/attachment indicator light **(#6)** will be off.

5. Treatments

5.1 Treatment areas

Use the device on these areas of your face.

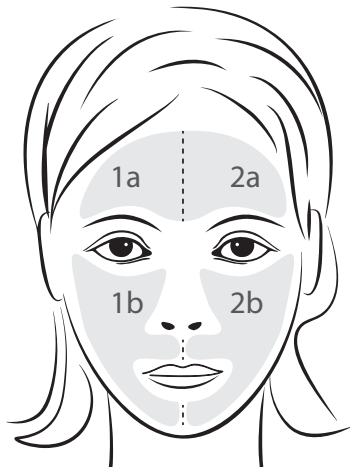


Forehead (1a, 2a)

Cheeks, nasolabial fold, chin(1b,2b)

- i** When treating larger areas, such as cheeks, we recommend using the RF attachment (#9) - see section [6.2 Treatment steps for use on larger areas](#).

5.2 Treatment plan

- Treat **each area** separately for 15 minutes. You can treat as many areas as you like in one session.
- Treat **each area** for at least 10 minutes at energy level **4**.
- Use the device for 2 sessions a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks / 10 treatments.



- Treat once every 2 weeks after that, to maintain results.

For maximum effectiveness:

- Make sure you have enough gel on the treatment surface (#1) at all times during the treatment.
- Do not leave the device on one spot of skin. Keep moving the device covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the treatment area, and reduce the possibility of any adverse effect.
- Make sure the 3 electrodes (#2) are always in full contact with the skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change energy levels when the treatment surface (#1) is **not** in contact with the skin.

5.3 What to expect

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- A sensation of warmth.
- Some redness or slight swelling: this should subside within a few hours, or up to one day.

5.4 Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days. In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 10 minutes and apply an anti-burn cream.
 - In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in a temporary redness for a few days. Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time. If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.
- i** Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.

6. Get started!

1. Make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewelry.
2. Remove the device and the other components from the box.
3. Decide if you want to use the device cordlessly or via the mains supply.
 - **Cordless:** Check that the battery is not low before you start a treatment.
 - **Mains supply:** Place the wall adapter cable into the wall adapter socket (#7) and connect to the mains supply.


6.1 Treatment steps for use on smaller areas

1. **Start the device:** Long press the control button (#8). The device starts at energy level 1 automatically, and 1 energy level indicator light (#5) will turn on.



EN


2. Apply a thin layer of Silk'n Slider Gel over the treatment surface (#1).
i Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Slider Gel and apply more gel if needed.
3. Using energy level 1, place the device on the area you want to treat. Make sure that it is in full contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.
4. Move the device in gentle massage-like motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Keep moving the device ensuring that the 3 electrodes stay in contact with the skin as you treat the area.
5. With the device constantly in motion, treat **each** area for 15 minutes.
6. Increase the energy level gradually. Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is comfortable for the area you are treating.

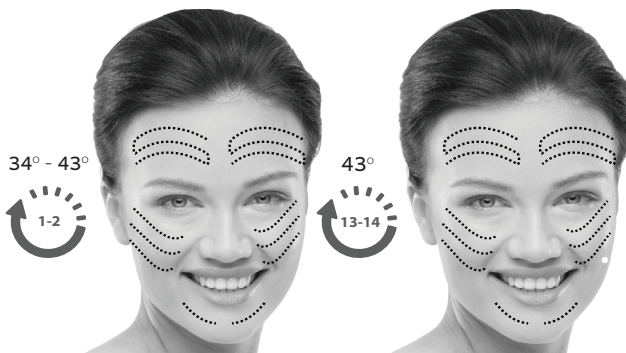

- i** You will feel the skin temperature rise as you increase the energy level. It usually takes about 1-2 minutes for the device to reach the required temperature. During the treatment your skin will get a little red. Don't worry; this is normal.
- ⚠ Stop immediately if you feel any discomfort.
7. Experiment by moving the device slowly across the area you are treating. If the treated area is hot and you feel uncomfortable, try moving the device a little faster.
 8. **Clean the treated area:** Remove any residual gel from the skin, then rinse the skin with lukewarm water. Dry the skin with a towel, and apply a facial cream to soothe and moisturize the skin.

6.2 Treatment steps for use on larger areas

For larger areas, such as cheeks, we recommend you use the RF attachment (#9).

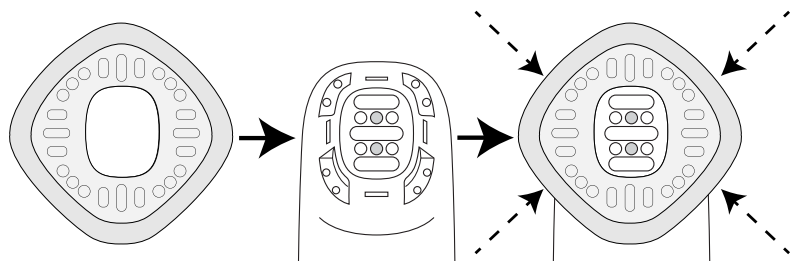

RF attachment

1. Place the RF attachment (#9) on the treatment surface (#1) and gently press it so that it locks into place. Make sure that the triangular mark on the back of the attachment faces upwards.
 - If the RF attachment is installed correctly, the battery/attachment indicator light (#6) will be constant green during use.
 - The LED lights (#3) and Infrared lights (#4) will also be on.
- i** If the RF attachment is not installed correctly, the battery /attachment indicator light (#6) blinks green. If that happens, re-install the attachment.
2. Once the attachment is positioned correctly, follow the treatment steps in section [6.1 Treatment steps for use on smaller areas](#).
3. **Remove the RF attachment:** Gently pull the attachment outwards until it detaches from the device. Clean and dry it before storing for next use - see section [7. Cleaning, maintenance & storage](#).

7. Cleaning, maintenance & storage


Clean the device and the RF attachment (#9) after each treatment.

 Never immerse your device or any of its parts in water!

- To clean the device, put the device in standby mode, then unplug it.
 - Use absorbent paper (such as toilet paper or wipes) to remove the gel residue off the treatment surface (#1). Make sure you remove all gel residue to prevent the gel from solidifying or damaging the device.
 - Use a clean damp cloth to clean the device and the treatment surface (#1).
 - Clean and dry the RF attachment (#9) in the same way.
- i** You may use cleaning fluids with up to 70% alcohol, but never use acetone or other abrasive liquids, because they will damage your device.
- Finally, wipe the device and the treatment surface (#1) dry with a clean dry cloth.



- After cleaning, we recommend you store the device in its original box. Store the device and the gel in a cool dry place.



8. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your device. You may exposure yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
The device does not start.	<ul style="list-style-type: none"> Mains supply: Make sure the wall adapter is properly connected to the device, that it is plugged into the mains supply, and that you long press the control button (#8). Cordless: Check that the battery is not low. If the battery is low, connect the device to the mains supply to perform the treatment.
I don't feel any heat from the device even though I pressed the control button (#8).	Heat will only be emitted when the treatment surface (#1) is in full contact with the skin, and you have applied gel before and/or during your treatment.
One or more lights blink continuously.	The device has malfunctioned. Unplug the device and restart.
The device has stopped working and is in standby mode.	<ul style="list-style-type: none"> Mains & cordless: Long press the control button (#8) to restart the device. Cordless: Check that the battery is not low.

For problems or queries, please contact Customer Service.

9. Customer service

For more information about Silk'n products, visit your regional Silk'n website: www.silkn.com or www.silkn.ca. If the device is damaged, defective, in need of repair or if you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from the websites.

Service number: 1-800-250-5053 (toll-free)
Email: customercarena@silkn.com

10. Consumables

You can purchase Silk'n Slider Gel at www.silkn.com and www.silkn.ca.

11. Warranty

This product is covered by a 1-year warranty. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service centre. Our customer service is always pleased to help you!

i The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.

12. Disposal

If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow local regulations for the disposal of electrical items. Contact your local council for more information.

Old appliances should not be disposed of with household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your locality. This ensures that old appliances and packaging are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment.



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.




Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb lead.

13. Labeling

The image is for illustration purposes only.

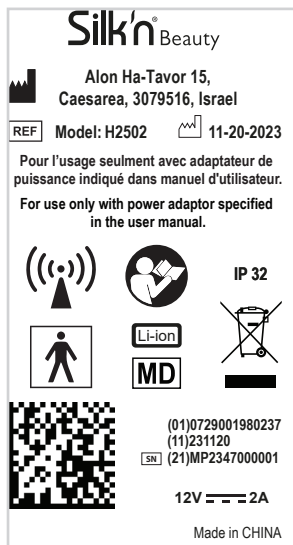

- i** This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

14. Signs & symbols

	A statement or event that indicates a possible or impending danger, problem when using the device.
i	Important information about using or maintaining the device.
IP32	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.
	Lithium-ion inside.
	The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Discard in accordance with local regulations.
	Interference may occur in the vicinity of the equipment.



Degree of protection against electric shock:
type BF applied part.



Date of manufacture.



Manufacturer.



Product serial number.



Product reference number.



Medical device.



Read the user manual.


15. Specifications

Model no.	Handpiece: H2502 RF Attachment: HA2502
Treatment area	Handpiece: 426 mm ² RF Attachment: 1012 mm ² RF Attachment + RF Head: 1438 mm ²
Technology	Home Technology™
Red LED light (wavelength; optical output power)	Handpiece: 22±0.66 mW/cm ² RF Attachment: 20±0.6 mW/cm ²
Infrared (wavelength; optical output power)	Handpiece: 23±0.69 mW/cm ² RF Attachment: 18±0.54 mW/cm ²
Radiofrequency (RF) (frequency; maximum output power)	Handpiece: 1 MHz ±30%; 10W max Handpiece + RF Attachment: 1 MHz ±30%; 20W max
Operation & safety	Heat stabilizer preventing skin overheating
Dimensions	
Handpiece + RF Attachment	189 x 71 x 61 mm ²
System weight	
Handpiece; RF Attachment	210 gm; 45 gm
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes

Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes	
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: minus 40 to 70°C Relative humidity: 10% - 90% Atmospheric pressure: 500 - 1060 hPa	
Operating conditions	Temperature: 10 to 35°C Relative humidity: 30% - 75% Atmospheric pressure: 700 - 1060 hPa	
Wall adapter Input Output Protection class	DZ024CHL120200H 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A 12.0 V DC, 2.0 A, 24.0 W II	
The device was tested and complies with these standards	IEC 60601-1 (Safety) IEC 60601-2-2 (High Frequency) IEC 60601-1-2 (EMC) IEC 60601-1-11 (Environment) IEC60601-2-83 (Safety of home light therapy equipment)	
Expected service life of the equipment	5 years	
Rechargeable Li-on battery	Model:	INR21700-40T
	Nominal voltage:	3.7Vdc
	Rated capacity:	4000mAh


16. Output power curves

The graphs show the device RF power (for all modes of operation) versus the treated skin impedance.

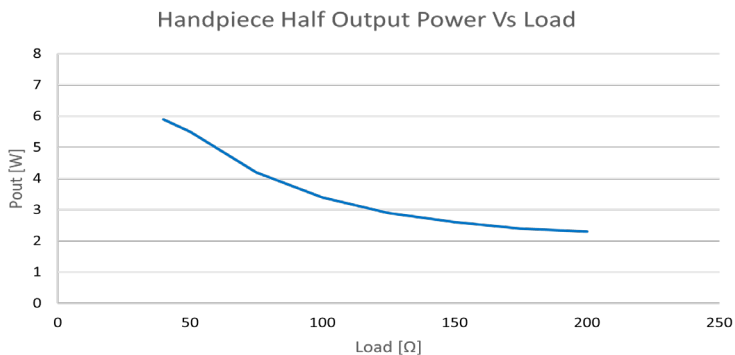


Handpiece Half Output Power Vs Load

Handpiece Full Output Power Vs Load

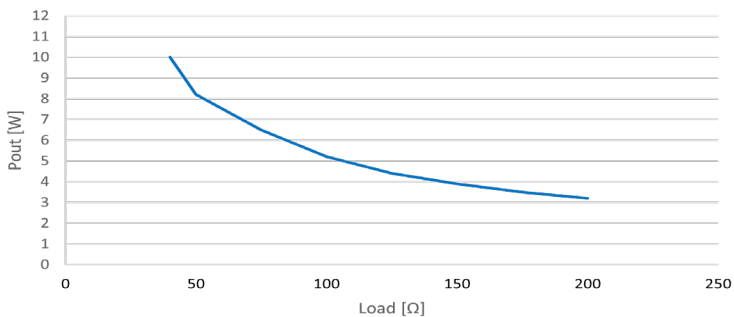


Handpiece Full Output Power Vs Load

Handpiece and RF Attachment Half Output Power Vs Load

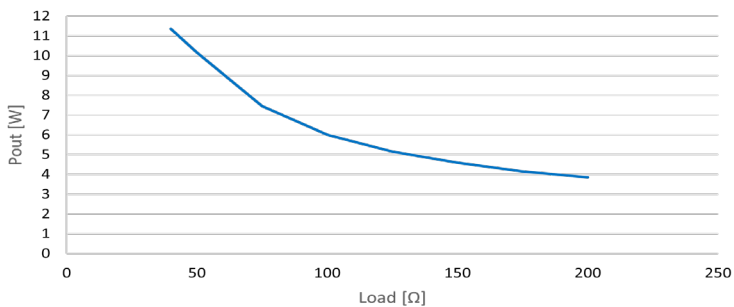

Handpiece and RF Attachment Half Output Power Vs Load

Handpiece and RF Attachment Full Output Power Vs Load

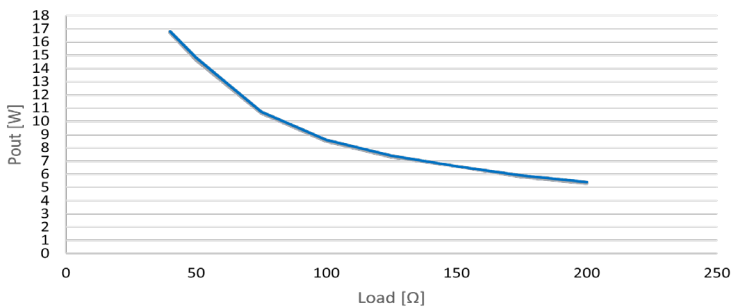

Handpiece and RF Attachment Full Output Power Vs Load

17. EMC Technical results

EMC requirements

IEC 60601-1-2 Edition 4.0 (2014)

Environment of intended uses:

Home Healthcare Facility Environment

Summary of Test Results

Test	Standard	Class/ Severity level	Test result
Emission (IEC 60601-1-2 section 7)			
Radiated emission Freq. range: 30 - 1000 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Immunity (IEC 60601-1-2 section 8)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	8 kV contact discharges & 15 kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz	Complies
Immunity from Proximity field from wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	List of frequencies, from 9 V/m up to 28 V/m, PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz	Complies
Immunity from power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50 Hz	Complies

18. Legal notice

Copyright 2024 © Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved.

Silk'n Beauty Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Silk'n Beauty Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Silk'n Beauty Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Silk'n Beauty Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Silk'n Beauty Ltd. Data is subject to change without notification. Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd., Alon Ha-Tavor 15, Caesarea, 3079516, Israel, www.silkn.com, www.silkn.ca, info@silkn.com.

Table des matières

1. Avertissements	20
2. Contre-indications.....	21
3. Dispositifs de sécurité	22
4. En savoir plus sur votre appareil	23
4.1 Description de l'appareil	23
4.2 Usage prévu	23
4.3 Contenu de l'emballage.....	23
4.4 Composants de l'appareil.....	23
4.5 Paramètres et commandes de l'appareil	24
4.6 Chargement de la batterie	24
5. Séances de traitement.....	25
5.1 Zones de traitement.....	25
5.2 Protocole d'utilisation	25
5.3 Quels résultats faut-il espérer	26
5.4 Effets secondaires possibles.....	26
6. Lancez-vous !.....	27
6.1 Étapes de traitement sur des petites zones.....	27
6.2 Étapes de traitement sur de grandes zones.....	28
7. Nettoyage, entretien et stockage.....	29
8. Dépannage.....	30
9. Service à la clientèle	30
10. Consommables	30
11. Garantie	31
12. Mise au rebut	31
13. Étiquetage	31
14. Signes et symboles	32
15. Caractéristiques techniques	33
16. Courbes de puissance de sortie.....	34
17. Résultats techniques concernant la CEM	34
18. Mentions légales.....	34

1. Avertissements



Cet appareil est puissant et doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

- Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant d'utiliser l'appareil, de toucher la prise ou de brancher le support de chargement à l'alimentation secteur.
- Veillez à ne pas placer ou ranger l'adaptateur mural où il risque de tomber ou d'être précipité dans un liquide.
- Afin de recharger la batterie, n'utilisez que l'adaptateur mural fourni avec cet appareil.
- N'utilisez pas l'adaptateur mural s'il est tombé dans un liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur après avoir chargé la batterie.
- Conservez l'appareil et l'ensemble des pièces et accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation secteur.
- N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulerait également votre garantie.
- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce mode d'emploi, ou s'ils sont endommagés de quelque façon que ce soit ou ne semblent pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Le cas échéant, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- Ne nettoyez pas les pièces au lave-vaisselle.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
- Cet appareil a été conçu et testé pour satisfaire aux exigences des normes électromagnétiques, électrostatiques et d'interférences de fréquence radio. Toutefois, la possibilité d'interférences électromagnétiques ou autres peut subsister. Le déplacement de l'appareil peut favoriser l'élimination des interférences.
- Ne jetez pas l'appareil ou la batterie avec les ordures ménagères ! La loi exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
- Jetez la batterie en respectant les consignes de sécurité.
- Si le produit atteint sa fin de vie, la batterie doit être retirée avant la mise au rebut (voir la rubrique 12. Mise au rebut).

2. Contre-indications

L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

Ne pas utiliser si vous :

- portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps ;
- souffrez de troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes ;
- avez des antécédents de cancer de la peau, ou êtes actuellement atteinte d'un autre type de cancer ou de grains de beauté pré-malins ;
- avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou des zones sujettes à des malignités dermatiques
- avez un système immunitaire affaibli en raison de maladies immunodépressives comme le SIDA et une infection par le VIH, ou si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs ;
- avez subi un traitement à base d'isotrétinoïne (Accutane®) au cours des 6 derniers mois précédant la séance ;

- avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- souffrez d'épilepsie ;
- êtes enceinte ou allaitez.

 **Ne pas utiliser sur les zones qui ont :**

- un implant permanent tel que des plaques métalliques et des vis, des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés ;
- une affection active, quelle qu'elle soit, dans la zone de traitement telle que des plaies, du psoriasis, de l'eczéma, des éruptions cutanées, des lacérations ouvertes, des écorchures ou des lésions ;
- subi des traumatismes ou des lésions cutanées ;
- été exposé au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.
- avez subi une opération chirurgicale au cours des 3 mois précédant la séance.
- avez des tatouages.
- avez des cheveux longs ou épais. L'utilisation de l'appareil peut provoquer de légères ecchymoses.

 **Consultez votre médecin si vous avez :**

- utilisé des corticostéroïdes au cours des 3 mois précédant la séance ;
- présenté une couperose ou une rosacée ;
- présenté des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement. Si tel est le cas, vous pourrez uniquement subir un traitement en suivant un régime prophylactique ;
- utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois ;
- présenté des antécédents de troubles cutanés, de chéloïdes, de cicatrisation anormale, ainsi qu'une peau très sèche et fragile ;
- toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

3. Dispositifs de sécurité

L'appareil possède ces caractéristiques qui protègent votre peau contre toute surchauffe cutanée.

- **Capteur et stabilisateur thermique :** Ces dispositifs mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 43 °C, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.
- **Capteur de mouvement :** Permet à l'appareil d'émettre une énergie RF uniquement lorsque vous faites glisser celui-ci sur votre peau.

4. En savoir plus sur votre appareil

4.1 Description de l'appareil

L'appareil est un dispositif de soin du visage qui utilise la technologie Home Tightening™. L'appareil combine plusieurs types d'énergie : La thérapie par laser de faible énergie (TLFE), l'énergie infrarouge et l'énergie de radiofréquence bipolaire (RF bipolaire) qui traitent la couche supérieure de la peau, le derme et la couche adipeuse sous-cutanée profonde en vue d'améliorer l'aspect de la peau et diminuer les rides.

L'appareil a une surface de traitement dotée de 3 pastilles métalliques et un bouton de commande avec 5 voyants lumineux pour indiquer le niveau d'énergie environnant. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable pour une utilisation sans fil, ainsi que d'un adaptateur mural pour la connexion à l'alimentation secteur.

4.2 Usage prévu

L'appareil est un appareil à usage domestique en vente libre conçu pour le traitement non invasif des rides du visage légères à modérées chez les femmes adultes présentant un type de peau de I à IV selon la classification de Fitzpatrick (voir le tableau des couleurs de peau au début du mode d'emploi).

Cet appareil est conçu pour une utilisation personnelle à la maison, et ne convient pas à une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

4.3 Contenu de l'emballage




- Votre appareil Silk'n
- Accessoire RF
- Un gel Silk'n Slider
- Adaptateur mural CA/CC
- Mode d'emploi

4.4 Composants de l'appareil

Veuillez consulter le diagramme de la page (i) qui se trouve au début de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Surface de traitement (#1)
- Électrodes métalliques (#2)
- Lumières LED (#3)
- Lumières infrarouges (#4)
- 4 voyants indicateurs de puissance (#5)
- Voyant lumineux de la batterie/tête (#6)
- Prise de l'adaptateur mural (#7)
- Bouton de commande (#8)
- Accessoire RF (#9)


4.5 Paramètres et commandes de l'appareil

Bouton	Action	Fonction/Mode
Bouton de commande (#8) 	Appui long x 1	Démarre l'appareil. Premier niveau d'énergie - 1 voyant allumé
	Appui court x 1	Second niveau d'énergie - 2 voyants allumés
	Appui court x 2	Troisième niveau d'énergie - 3 voyants allumés
	Appui court x 3	Quatrième niveau d'énergie - 4 voyants allumés
	Appui court x 4	Retourne au premier niveau
	Appui long	Retourne en mode veille
Voyants indicateurs de puissance (#5) 	Affiche le niveau d'énergie sélectionné.	Chaque voyant correspond à une puissance différente. Le premier niveau d'énergie est la puissance la plus faible et le quatrième niveau est la plus élevée.
Voyant lumineux de la batterie/ tête (#6) 	Orange - clignotant Vert - fixe Orange - clignotant	Chargement de l'appareil Appareil chargé Batterie faiblement chargée (sans fil)

4.6 Chargement de la batterie

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Connectez le câble de l'adaptateur mural sur l'appareil, puis branchez l'adaptateur mural sur l'alimentation secteur. Le voyant lumineux de la batterie (#6) se met alors à clignoter en orange.
3. Positionnez l'adaptateur mural de façon à en facilement débrancher la prise.

i L'icône de la batterie ne change pas de couleur.

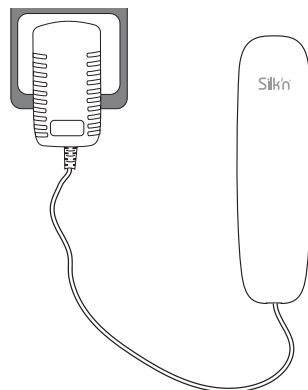

Charge initiale



Heures

Charge régulière



Heures

Utilisation sans fil




Minutes

- i** Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur. Notez que le voyant lumineux de la batterie (#6) s'éteint.

5. Séances de traitement

5.1 Zones de traitement

Utilisez l'appareil sur ces zones du visage.

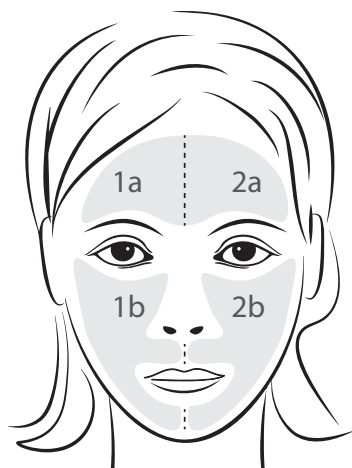

Front (1a, 2a)


Joues, pli naso-labial, menton
(1b 2b)

- i** Pour le traitement des zones de plus grande taille telles que les joues, nous vous recommandons l'utilisation de l'accessoire RF (#9) — voir la section [6.2 Étapes de traitement sur de grandes zones](#).

5.2 Protocole d'utilisation

- Traitez **chaque zone** séparément pendant 15 minutes. Vous pouvez traiter autant de zones que vous le souhaitez en une seule séance.
- Traitez **chaque zone** pendant au moins 10 minutes à la puissance **4**.

- Utilisez l'appareil à raison de deux séances par semaine pendant 10 semaines. Vous commencerez à observer des résultats visibles au bout de 5 semaines/10 traitements.



- Après cela, réalisez un traitement une fois toutes les deux semaines pour maintenir les résultats.

Pour une efficacité maximale :

- Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de gel sur la surface de traitement (**#1**) à tout moment au cours de la séance.
- Ne laissez pas l'appareil sur un seul endroit de la peau. Déplacez-le continuellement afin de couvrir toute la zone de traitement. Cela permettra d'éviter de surchauffer la zone de traitement et réduira la possibilité d'un effet indésirable.
- Veillez à ce que les trois électrodes (**#2**) soient toujours en contact direct avec la peau.
- Si la puissance provoque une sensation d'inconfort, réduisez-la jusqu'à un niveau qui soit confortable pour vous.
- Modifiez uniquement les niveaux d'énergie lorsque la surface de traitement (**#1**) n'est **pas** en contact avec la peau.

5.3 Quels résultats faut-il espérer

Voici ce qu'il est normal d'attendre ou de ressentir durant une séance :

- Une sensation de chaleur
- Quelques rougeurs ou un léger gonflement qui devraient se résorber en quelques heures ou en un jour maximum.

5.4 Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions dans leur intégralité et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

- Les œdèmes excessifs (gonflement) et les érythèmes (rougeur) sont des réactions rares au traitement qui dans la plupart des cas se résorbent en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 10 minutes et appliquez une crème anti-brûlure.

- Dans certains cas rares, l'utilisatrice peut présenter une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs transitoires pendant quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de rafraîchir immédiatement la zone concernée avec de l'eau glacée.
- i Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, y compris des douleurs, des rougeurs cutanées, des gonflements ou une sensation de brûlure.

6. Lancez-vous !


1. Assurez-vous d'avoir une peau propre et sèche et libre de bijoux.
2. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
3. Décidez si vous souhaitez utiliser l'appareil sans fil ou via l'alimentation secteur.
 - **Sans fil :** Avant de démarrer une séance, vérifiez que la batterie est assez chargée.
 - **Alimentation secteur :** Branchez le câble de l'adaptateur mural sur la prise (#7) de l'adaptateur mural, et branchez ce dernier sur l'alimentation secteur.

6.1 Étapes de traitement sur des petites zones

1. **Démarrez l'appareil :** Effectuez un appui long sur le bouton de commande (#8). L'appareil démarre au niveau d'énergie 1 automatiquement, et le voyant lumineux de niveau d'énergie 1 (#5) s'allume.
- i Vérifiez que la date de péremption du gel n'est pas dépassée.
2. Appliquez une fine couche de gel Silk'n Slider sur la surface de traitement (#1).
- i Le gel Slider (ou n'importe quel autre gel transparent à base d'eau) rend les mouvements de la surface de traitement plus lisses sur la peau et assure une bonne conductivité. Afin de garantir une séance sûre et efficace, commencez toujours par appliquer du gel Slider et appliquez-en davantage au besoin.
3. Placez l'appareil, sur le niveau d'énergie 1, sur la zone à traiter. Veillez à ce que celui-ci soit en contact direct avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.
4. Déplacez l'appareil en effectuant de légers mouvements, tel un massage, sur la zone que vous souhaitez traiter. Progressez lentement et avec précaution. Continuez à déplacer l'appareil en vous assurant que les 3 électrodes restent en contact avec la peau à mesure que vous traitez la zone.
5. En déplaçant continuellement l'appareil, traitez **chaque zone pendant 15 minutes**.



6. Augmentez progressivement le niveau d'énergie. Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant la puissance la plus élevée, mais il est important que vous choisissiez le niveau

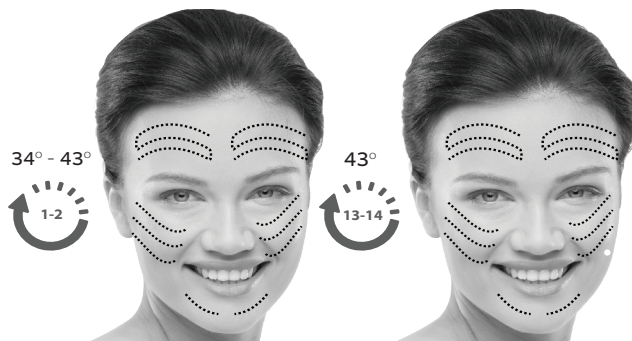

d'énergie confortable pour la zone à traiter.


- i** Vous ressentirez une augmentation de la température de la peau à mesure que vous augmenterez la puissance. L'appareil prend généralement environ 1 à 2 minutes pour atteindre la température requise. Au cours de la séance, votre peau deviendra un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.

! Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

7. Faites des essais en déplaçant lentement l'appareil sur la zone traitée. Si la zone traitée est chaude et que la sensation éprouvée est désagréable, essayez de déplacer l'appareil un peu plus rapidement.
8. **Nettoyez la zone traitée :** Retirez toute trace résiduelle de gel, puis rincez la peau à l'eau tiède. Séchez la peau avec une serviette et appliquez une crème de visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.

6.2 Étapes de traitement sur de grandes zones

Pour les zones de plus grande taille telles que les joues, nous vous recommandons l'utilisation de l'accessoire RF (#9).

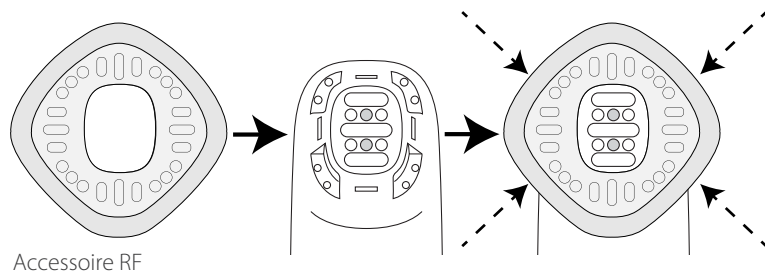

Accessoire RF

1. Positionnez l'accessoire RF (#9) sur la surface de traitement (#1) et appuyez doucement sur celui-ci pour qu'il s'enclenche. Assurez-vous que le repère triangulaire situé à l'arrière de l'accessoire est orienté vers le haut.

- Si l'accessoire RF est correctement installé, le voyant lumineux de batterie/accessoire (#6) est allumé en vert de façon continue pendant l'utilisation.
 - Les lumières LED (#3) et infrarouges (#4) restent également allumés.
- i** Si l'accessoire RF n'est pas installé correctement, le voyant lumineux de batterie/accessoire (#6) clignote en vert. Le cas échéant, réinstaller l'accessoire.
2. Une fois l'accessoire correctement positionné, suivez les étapes de traitement de la section 6.1 Étapes de traitement sur des petites zones.
 3. **Retirez l'accessoire RF :** Tirez doucement sur l'accessoire jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil. Nettoyez-le et séchez-le avant de le ranger en vue de la prochaine utilisation — voir la section 7. Nettoyage, entretien et stockage.

7. Nettoyage, entretien et stockage

Nettoyez l'appareil et l'accessoire RF (#9) après chaque traitement.

- ⚠ N'immergez jamais votre appareil ou l'un de ses composants dans l'eau !
 - Mettez l'appareil en mode veille avant de le débrancher.
 - Utilisez des serviettes de papier absorbant (telles que du papier hygiénique ou des lingettes) pour retirer les traces résiduelles de gel de la surface de traitement (#1). Vérifiez que vous avez bien nettoyé toute trace de gel afin que le gel ne se solidifie pas et n'endommage pas l'appareil.
 - Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil et la surface de traitement (#1).
 - Nettoyez et séchez l'accessoire RF (#9) de manière similaire.
- i** Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.
- Pour finir, séchez l'appareil ainsi que la surface de traitement (#1) en les essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec.
 - Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine. Conservez l'appareil et le gel dans un endroit sec et frais.



8. Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation secteur : Assurez-vous que l'adaptateur mural est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans l'alimentation secteur, puis effectuez un appui long sur le bouton de commande (#8).• Sans fil : Vérifiez que la batterie est assez chargée. Si la batterie est faible, branchez l'appareil sur l'alimentation secteur pour effectuer une séance.
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil, alors que j'ai bien appuyé sur le bouton de commande (#8).	La chaleur est émise uniquement lorsque la surface de traitement (#1) est en contact direct avec la peau et que vous avez appliqué du gel avant et/ou pendant la séance.
Un ou plusieurs voyants lumineux clignotent de manière continue.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en mode veille.	<ul style="list-style-type: none">• Secteur et sans fil : Effectuez un appui long sur le bouton de commande (#8) pour redémarrer l'appareil.• Sans fil : Vérifiez que la batterie est assez chargée.

9. Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.com et www.silkn.ca. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir des sites www.silkn.com et www.silkn.ca.

Les détails de notre contrat sont :

Numéro de service : 1-800-250-5053 (sans frais)

E-mail : customerarena@silkn.com

10. Consommables

Vous pouvez acheter le gel Silk'n Slider à www.silkn.com et www.silkn.ca.

11. Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

- i** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou incorrecte.

12. Mise au rebut

Si votre appareil atteint sa phase de fin de vie, veillez à respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut des articles électriques. Contactez la mairie de votre domicile pour plus d'informations.

Les appareils usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères !

Si le produit venait à ne plus pouvoir être utilisé à un moment donné, mettez-le au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre localité. Cela garantit que les anciens appareils et emballages sont recyclés par des professionnels et exclut les conséquences négatives pour l'environnement.



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.









Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

13. Étiquetage

Consultez la rubrique correspondante en anglais.

14. Signes et symboles

	Déclaration ou événement indiquant un problème, un danger potentiel ou imminent lors de l'utilisation de l'appareil.
	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
IP32	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.
	Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Mettre au rebut conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.
	Lithium à l'intérieur.
	La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Mettre au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans votre région.
	Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement.
	Degré de protection contre les chocs électriques : partie appliquée de type BF.
	Date de fabrication.
	Fabricant.
	Numéro de série du produit.
	Numéro de référence du produit.
	Appareil médical.
	Veuillez lire le mode d'emploi.

- i** Cet appareil ne convient pas à l'utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable à l'air, avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

15. Caractéristiques techniques

Modèle	Pièce à main : H2502 Accessoire RF : HA2502
Zone de traitement	Pièce à main : 426 mm ² Accessoire RF : 1 012 mm ² Accessoire RF + tête RF : 1 438 mm ²
Technologie	Home Technology™
Voyant LED rouge (longueur d'onde, puissance de sortie optique)	Pièce à main : 22 ± 0,66 mW/cm ² Accessoire RF : 20 ± 0,6 mW/cm ²
Infrarouge (longueur d'onde, puissance de sortie optique)	Pièce à main : 23 ± 0,69 mW/cm ² Accessoire RF : 18 ± 0,54 mW/cm ²
Radiofréquence (RF) (fréquence ; puissance de sortie maximale)	Pièce à main : 1 MHz ± 30 % ; 10 W max Pièce à main + accessoire RF : 1 MHz ± 30 % ; 20 W max
Fonctionnement et sécurité	Stabilisateur thermique empêchant la surchauffe de la peau
Dimensions	
Pièce à main + accessoire RF	189 x 71 x 61 mm ²
Poids du système	
Pièce à main ; accessoire RF	210 g ; 45 g
Temps pour passer de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Temps pour passer de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : - 40 à 70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35 °C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Adaptateur mural Entrée Sortie Classe de protection	DZ024CHL120200H 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A 12 VCC, 2 A, 24 W II

L'appareil a été testé et est conforme aux normes suivantes	IEC 60601-1 (Sécurité) IEC 60601-2-2 (Haute fréquence) IEC 60601-1-2 (CEM) CEI 60601-1-11 (Environnement) CEI 60601-2-83 (Sécurité des appareils de luminothérapie à domicile)	
Durée de vie prévue de l'équipement	5 ans	
Batterie Li-on rechargeable	Modèle :	INR21700-40T
	Tension nominale :	3.7 Vcc
	Capacité nominale :	4 000 mAh

16. Courbes de puissance de sortie

Consultez la rubrique correspondante en anglais.

17. Résultats techniques concernant la CEM

Consultez la rubrique correspondante en anglais.

18. Mentions légales

Copyright 2024 © Silk'n Beauty Ltd. Tous droits réservés.

Silk'n Beauty Ltd. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productivité. Tous les renseignements fournis par Silk'n Beauty Ltd. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Silk'n Beauty Ltd. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ou autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Silk'n Beauty Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit et à quelque fin que ce soit sans la permission écrite expresse de Silk'n Beauty Ltd. Les données sont modifiables sans préavis. Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd., Alon Ha-Tavor 15, Caesarea, 3079516, Israël, www.silkn.com, www.silkn.ca, info@silkn.com.

Índice

1. Advertencias	36
2. Contraindicaciones.....	37
3. Características de seguridad	38
4. Conozca su dispositivo	38
4.1 Descripción del dispositivo	38
4.2 Uso previsto	39
4.3 Contenido del paquete	39
4.4 Partes del dispositivo.....	39
4.5 Controles y ajustes del dispositivo.....	39
4.6 Cargar la batería	40
5. Tratamientos	41
5.1 Zonas de tratamiento	41
5.2 Plan de tratamiento	41
5.3 Qué debe esperar	42
5.4 Posibles efectos secundarios.....	42
6. Primeros pasos.....	43
6.1 Pasos de tratamiento para zonas más pequeñas	43
6.2 Pasos de tratamiento para zonas más grandes	44
7. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento.....	44
8. Resolución de problemas.....	45
9. Atención al cliente	46
10. Consumibles.....	46
11. Garantía	46
12. Eliminación de residuos	46
13. Etiquetado	47
14. Signos y símbolos	47
15. Especificaciones.....	48
16. Curvas de potencia de salida	49
17. Resultados técnicos de CEM	49
18. Aviso legal	49

1. Advertencias



Este dispositivo es potente y debe prestarse especial atención a la seguridad durante su uso. Antes de usar el dispositivo, lea este manual del usuario al completo y guárdelo para futuras referencias. Por favor, lea y siga estrictamente todas las advertencias y precauciones de seguridad. Le recomendamos que revise de nuevo las instrucciones antes de cada tratamiento.

- Asegúrese de que tiene las manos secas antes de utilizar el dispositivo, tocar el enchufe o conectar la base de carga a la red eléctrica.
- No coloque o guarde el adaptador de pared en un lugar donde pueda caerse o entrar en contacto con algún líquido.
- Para recargar la batería, utilice solamente el adaptador de pared que se proporciona con este dispositivo.
- No utilice el adaptador de pared si ha caído dentro de algún líquido.
- Desconecte el dispositivo del suministro eléctrico tras cargar la batería.
- Mantenga el dispositivo y todas sus piezas y accesorios alejados de superficies calientes.
- Nunca deje el dispositivo sin vigilancia mientras está conectado a la red eléctrica.
- No intente modificar, abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y puede sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.
- No utilice el dispositivo si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante tal y como se describe en este manual, si los accesorios están dañados o parecen no funcionar adecuadamente o si ve o huele humo. En dichos casos, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No limpie ninguna de las piezas en lavavajillas.
- No deje que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños.
- No deje que los niños jueguen con el embalaje. Pueden hacerse daño con el material de embalaje o ingerir piezas pequeñas y atragantarse.

- Este dispositivo contiene baterías que no son recambiables.
- Esta unidad se ha diseñado y probado para cumplir con los requisitos de los estándares sobre interferencias electromagnéticas, electrostáticas y de radiofrecuencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que se produzcan interferencias electromagnéticas o de otro tipo. Reubicar el dispositivo puede ayudar a eliminar las interferencias.
- No deseche el dispositivo ni la batería con los residuos domésticos normales. La ley requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto limpio o punto derecogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos.
- Deseche la batería de forma segura.
- Si el producto alcanza el fin de su vida útil, debe extraerse la batería antes de desechar el producto (consulte la sección [12. Eliminación de residuos](#)).

2. Contraindicaciones

Este dispositivo no debe ser usado por las siguientes personas: niños, adultos con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas limitadas o personas que carezcan de experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo de forma segura o que no comprendan los riesgos que implica.

No lo utilice si:

- lleva un marcapasos, un desfibrilador interno o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- padece algún trastorno endocrino no controlado, como diabetes o trastornos de la tiroides.
- tiene antecedentes de cáncer de piel o padece cualquier otro tipo de cáncer o lunares premalignos.
- si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia o si existen zonas con posibles malignidades dermatológicas.
- tiene el sistema inmune dañado debido a enfermedades inmunodepresoras como el SIDA y el VIH o utiliza medicamentos inmunosupresores.
- ha utilizado isotretinoína (Accutane®) en los seis meses anteriores al tratamiento.
- tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como la porfiria, erupción polimorfa lumínica, urticaria solar, lupus, etc.
- padece epilepsia.
- está embarazada o en período de lactancia.

No utilizar en zonas donde:

- exista un implante permanente, como placas o tornillos metálicos, implantes de silicona o donde se hayan inyectado toxinas o rellenos.
- exista enfermedad activa en la zona a tratar, como úlceras, psoriasis, eccema, erupciones, cortes abiertos, abrasiones o lesiones.
- existan traumatismos o lesiones en la piel.
- haya habido exposición reciente al sol sin protección (debe esperar un día); para pieles bronceadas o quemadas por el sol, espere tres días.
- se haya sometido a cirugía durante los tres meses previos al tratamiento.
- existan tatuajes.
- exista cabello largo o grueso. El uso del dispositivo puede causar un ligero hematoma.

Consulte con su médico si:

- ha tomado esteroides en los tres meses previos al tratamiento.
- tiene cuperosis o rosácea.
- tiene antecedentes de alguna enfermedad que se vea estimulada por el calor, como el herpes simplex recurrente, en la zona a tratar. En tal caso, podrá tratarse únicamente tras someterse a un tratamiento profiláctico.
- se ha aplicado medicamentos con receta médica en la piel en los últimos 6 meses.
- tiene antecedentes de enfermedades de la piel, queloides, cicatrización de heridas anormal o piel muy seca y frágil.
- tiene cualquier otra condición por la cual, en opinión de su médico o dermatólogo, no sea seguro llevar a cabo el tratamiento.

3. Características de seguridad

El dispositivo cuenta con las siguientes funciones para proteger su piel contra el sobrecalentamiento.

- **Sensor térmico y estabilizador de calor:** Miden la temperatura de la piel, estabilizan la energía térmica y evitan el sobrecalentamiento. Cuando la temperatura de la piel alcanza los 43 °C, el estabilizador detiene automáticamente la emisión de calor hasta que la temperatura de la piel desciende lo suficiente como para que dicho estabilizador reanude la emisión de calor.
- **Sensor de movimiento:** Permite que el dispositivo genere RF únicamente cuando está moviendo el dispositivo sobre la piel.

4. Conozca su dispositivo

4.1 Descripción del dispositivo

Este dispositivo es un dispositivo de tratamiento facial que utiliza Home Technology™. El dispositivo combina varios tipos de energías: Terapia láser de nivel bajo (LLLT), energía de radiofrecuencia infrarroja y bipolar (RF bipolar), que trata la capa superior, la dermis y la grasa subdérmica para mejorar el aspecto de la piel y reducir las arrugas.

El dispositivo cuenta con una superficie de tratamiento con tres electrodos y un botón de control con cinco luces indicadoras alrededor. Tiene una batería recargable para su uso sin cables y un adaptador de pared para conectarlo a la red eléctrica.

4.2 Uso previsto

El dispositivo es un dispositivo de uso doméstico diseñado para el tratamiento no invasivo de arrugas faciales leves a moderadas en mujeres adultas que tienen tipos de piel Fitzpatrick I-IV (consulte el gráfico de color de piel en la parte delantera del manual del usuario).

El dispositivo está destinado al tratamiento personal en casa y no es adecuado para fines comerciales. No utilice el dispositivo para ningún fin distinto de los descritos en este manual del usuario.

4.3 Contenido del paquete


- Su dispositivo Silk'n
- Accesorio de RF
- Gel Silk'n Slider
- Adaptador de pared CA/DC
- Manual del usuario



4.4 Partes del dispositivo

Consulte el diagrama en la página (i) al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada elemento.

- Superficie de tratamiento (#1)
- Electrodo (#2)
- Luces LED (#3)
- Luces infrarrojas (#4)
- 4 Luces indicadoras del nivel de energía (#5)
- Luz indicadora de batería/adjunto (#6)
- Enchufe adaptador de pared (#7)
- Botón de control (#8)
- Accesorio de RF (#9)


4.5 Controles y ajustes del dispositivo

Botón	Acción	Función/Modo
Botón decontrol (#8) 	Pulsación larga x 1	Inicia el dispositivo. Nivel de energía 1: 1 luz encendida
	Pulsación corta x 1	Nivel de energía 2: 2 luces encendidas
	Pulsación corta x 2	Nivel de energía 3: 3 luces encendidas
	Pulsación corta x 3	Nivel de energía 4: 4 luces encendidas
	Pulsación corta x 4	Vuelve al nivel 1
	Pulsación larga	Pasa a modo de espera

Botón	Acción	Función/Modo
Luces indicadoras del nivel de energía (#5) 	Muestra el nivel de energía seleccionado.	Hay una luz para cada nivel de energía. El nivel 1 es el nivel de energía más bajo y el nivel 4 es el más alto.
Luz indicadora de batería/ adjunto (#6) 	Naranja, parpadea Verde, constante Naranja, parpadea	Carga del dispositivo Dispositivo cargado Carga baja en la batería (sin cable)

4.6 Cargar la batería

1. Cargue el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
2. Coloque el cable del adaptador de pared en el dispositivo y a continuación conecte el adaptador de pared a la red eléctrica. La luz indicadora de la batería (#6) parpadeará en naranja.
3. Coloque el adaptador de pared de forma que la toma de corriente pueda desconectarse fácilmente.

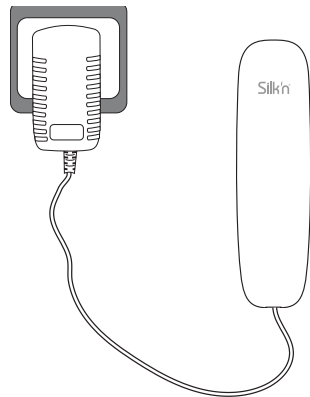

i El icono de la batería no cambia de color.



Horas



Horas




Minutos

i Puede usar el dispositivo cuando esté conectado a la red eléctrica. Tenga en cuenta que la luz indicadora de la batería (#6) estará apagada.

5. Tratamientos

5.1 Zonas de tratamiento

Utilice el dispositivo en estas zonas de su rostro.

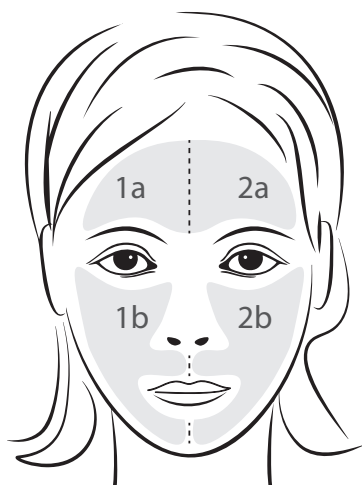


Frente (1a, 2a)

Mejillas, pliegues nasolabiales, barbilla (1b 2b)

- i** Cuando se traten zonas grandes, como las mejillas, recomendamos usar el accesorio de RF (#9); consulte la sección [6.2 Pasos de tratamiento para zonas más grandes](#).

5.2 Plan de tratamiento

- Trate **cada zona** por separado durante 15 minutos. Puede tratar tantas zonas como desee en una sesión.
- Trate **cada zona** durante al menos 10 minutos a un nivel de energía **4**.
- Utilice el dispositivo en dos sesiones semanales durante 10 semanas. Comenzará a ver resultados visibles tras 5 semanas/10 tratamientos.



- A partir de entonces, trátase una vez cada dos semanas para mantener los resultados.

Para una máxima efectividad:

- Asegúrese de que hay suficiente gel sobre la superficie de tratamiento (**#1**) en todo momento durante el tratamiento.
- No deje el dispositivo en un mismo punto de la piel. Mantenga el dispositivo en movimiento continuo, cubriendo toda la zona de tratamiento. De esta forma evitará sobrecalentar la zona de tratamiento y reducirá las posibilidades de que se produzcan efectos adversos.
- Asegúrese de que los tres electrodos (**#2**) estén siempre en contacto total con la piel.
- Si el nivel de energía le resulta molesto, redúzcalo hasta un nivel que le sea cómodo.
- Solo debe cambiar los niveles de energía cuando la superficie de tratamiento (**#1**) **no** esté en contacto con la piel.

5.3 Qué debe esperar

Durante una sesión del tratamiento, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- Una sensación de calor
- Cierta enrojecimiento o una ligera inflamación, que debería desaparecer en unas horas o en un plazo máximo de un día.

5.4 Posibles efectos secundarios

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a todas las advertencias y contraindicaciones, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Sin embargo, cualquier tratamiento cosmético, incluidos los diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden surgir.

- El edema (inflamación) y el eritema (enrojecimiento) excesivos son reacciones poco frecuentes al tratamiento y en la mayoría de casos desaparecen en unos días. Si aparecen estos signos, utilice inmediatamente un paño frío húmedo para enfriar la zona durante al menos 10 minutos y aplique una crema para quemaduras.
 - En casos raros, puede experimentar una dilatación de los capilares superficiales. Esto puede causar cierto enrojecimiento durante unos días. Además, algunos capilares pueden presentar manchas rojas, que también desaparecerán con el tiempo. Si esto sucede, recomendamos enfriar la zona inmediatamente con agua fría.
- i** Consulte a su médico si sufre algún síntoma persistente, como dolor, enrojecimiento de la piel, inflamación o sensación de quemazón.

6. Primeros pasos

1. Asegúrese de que su piel está limpia y seca y que se ha quitado todas las joyas.
2. Extraiga el dispositivo y el resto de componentes de la caja.
3. Decida si desea usar el dispositivo sin cable o conectado a la red eléctrica.
 - **Sin cables:** Compruebe que la batería no está baja antes de iniciar el tratamiento.
 - **Con suministro eléctrico:** Conecte el cable adaptador al enchufe del adaptador de pared (#7) y conecte este a la red eléctrica.

6.1 Pasos de tratamiento para zonas más pequeñas

1. **Inicie el dispositivo:** Pulse durante varios segundos el botón de control (#8). El dispositivo se inicia automáticamente en el nivel de energía 1, e la luz indicadora del nivel de energía 1 (#5) se encenderá.


i Compruebe que la fecha de caducidad del gel no ha vencido.

2. Aplique una pequeña cantidad del Silk'n Slider Gel en la superficie de tratamiento (#1).



i El gel Slider (o cualquier otro gel transparente de base acuosa) facilita el suave deslizamiento de la superficie de tratamiento sobre la piel y permite la conductividad. Para garantizar un tratamiento seguro y eficiente, empiece siempre por aplicar gel Slider y repita la aplicación si es sario.

3. En el nivel de energía 1, coloque el dispositivo sobre la zona que desea tratar. Asegúrese de que esté en contacto total con la piel. Notará una leve sensación de calor.
4. Desplace el dispositivo realizando movimientos suaves, como si diera un masaje, sobre la zona a tratar. Vaya avanzando lentamente y con cuidado. Siga moviendo el dispositivo, asegurándose de que los tres electrodos permanecen en contacto con la piel a medida que trata la zona.
5. Con el dispositivo en constante movimiento, trate **cada** zona durante 15 minutos.
6. Aumente el nivel de energía gradualmente. Si usa el nivel de energía más alto obtendrá mejores resultados, pero es importante que use el nivel de energía que le resulte cómodo en la zona que esté tratando.

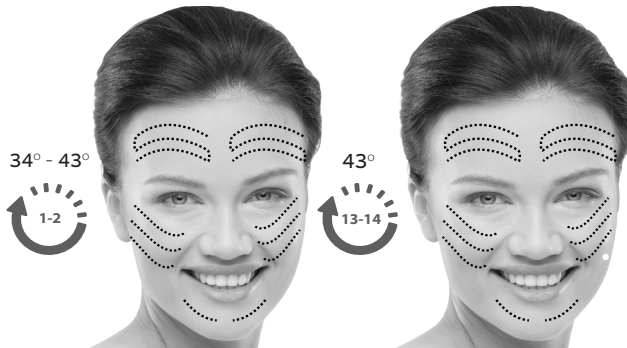


i Sentirá que la temperatura de la piel aumenta a medida que aumenta el nivel de energía. Normalmente, el dispositivo tarda entre 1 y 2 minutos en alcanzar la temperatura deseada. Durante el tratamiento, su piel se enrojecerá un poco. No se preocupe; esto es normal.

⚠ Detenga de inmediato el dispositivo si nota alguna molestia.

7. Pruebe a mover el dispositivo lentamente sobre la zona que está tratando. Si la zona tratada está caliente y le causa molestias, intente mover el dispositivo un poco más rápido.
8. **Limpie las zonas tratadas:** Elimine cualquier resto de gel de la piel y enjuague la piel con agua templada. Seque la piel con una toalla y aplique crema facial para calmar e hidratar.

6.2 Pasos de tratamiento para zonas más grandes

Para zonas más grandes, como las mejillas, recomendamos que utilice el accesorio de RF (#9).

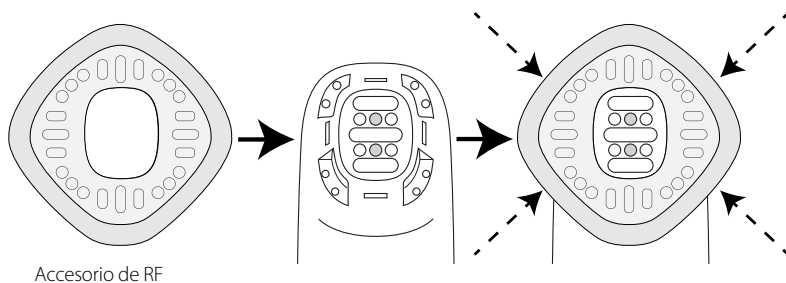

1. Coloque el accesorio de RF (#9) sobre la superficie de Tratamiento (#1), y suavemente presione para que se bloquee en su sitio. Asegúrese que la marca triangular en la parte trasera del accesorio mira hacia arriba.
 - Si el accesorio de RF se instala correctamente la luz indicadora de batería/accesorio (#6), se mostrará de color verde constante.
 - Las luces LED (#3) y las luces infrarrojas (#4) también estarán encendidas.
- i** Si el accesorio de RF no se instala correctamente, la luz indicadora de batería/accesorio (#6), parpadeará en verde. Si eso sucede, vuelva a instalar el accesorio.
2. Una vez que el accesorio esté colocado correctamente, siga los pasos de tratamiento en la sección 6.1 Pasos de tratamiento para zonas más pequeñas.
3. **Retirar el accesorio de RF:** Suavemente tire del accesorio hacia fuera hasta que se desconecte del dispositivo. Limpie y séquelo antes de guardarlo hasta el próximo uso; consulte la sección 7. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento.

7. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento


Limpie el dispositivo y el accesorio de RF (#9) tras cada tratamiento.

⚠ ¡Nunca sumerja su dispositivo ni ninguna de sus piezas en agua!

- Ponga el dispositivo en modo de espera y a continuación desenchúfelo.
- Utilice papel absorbente (como papel higiénico o toallitas) para eliminar los residuos de gel de la superficie de tratamiento (#1). Asegúrese de eliminar todos los residuos de gel para evitar que este se solidifique o dañe el dispositivo.



- Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el dispositivo y la superficie de tratamiento (#1).
- Limpie y seque el accesorio de RF (#9) de la misma forma.
- i** Puede usar líquidos limpiadores con hasta un 70 % de alcohol, pero nunca utilice acetona ni otros líquidos abrasivos, porque dañarán el dispositivo.
- Finalmente, seque el dispositivo y la superficie de tratamiento (#1) con un paño limpio y seco.
- Después de la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original. Guarde el dispositivo y el gel en un lugar fresco y seco.



8. Resolución de problemas

No intente abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
El dispositivo no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro eléctrico: Asegúrese de que el adaptador de pared está conectado adecuadamente al dispositivo y está enchufado a una toma de corriente en la pared, y que ha pulsado el botón de control (#8) durante varios segundos. • Sin cables: Asegúrese de que la batería no está baja. <p>Si la batería está baja, conecte el dispositivo a la red eléctrica para realizar el tratamiento.</p>
No noto que el dispositivo emita calor aunque he pulsado el botón de control (#8).	El calor solo se emitirá una vez que la superficie de tratamiento (#1) esté en contacto total con la piel y una vez que haya aplicado gel antes de y/o durante su tratamiento.
Una o más luces parpadean continuamente.	El dispositivo ha funcionado incorrectamente. Desenchufe el dispositivo y reinicie.
El dispositivo ha dejado de funcionar y está en modo de espera.	<ul style="list-style-type: none"> • Con suministro eléctrico y sin cable: Pulse durante varios segundos el botón de control (#8) para reiniciar el dispositivo. • Sin cables: Asegúrese de que la batería no está baja.

Si tiene algún problema o consulta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

9. Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos Silk'n, visite el sitio web regional de Silk'n: www.silkn.com o www.silkn.ca. Si el dispositivo está dañado, defectuoso, necesita reparación o si necesita nuestra ayuda, comuníquese con el centro de servicio Silk'n más cercano. Este manual también está disponible como descarga en PDF desde estos sitios web.

Los detalles de nuestro contrato son:

Número de servicio: 1-800-250-5053 (sin cargo)

Correo electrónico: customercarena@silkn.com

10. Consumibles

Puede adquirir el gel Silk'n Slider en www.silkn.com y www.silkn.ca.

11. Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de un año. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle.

i El fabricante no se hará responsable de ningún daño o lesión causada por un uso inadecuado o incorrecto.

12. Eliminación de residuos

Si su dispositivo alcanza el final de su vida útil, asegúrese de seguir la normativa local para la eliminación de objetos eléctricos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información.

Los aparatos en desuso no deben desecharse con los residuos domésticos normales.

Si el producto ya no puede utilizarse, deséchelo de acuerdo con la normativa vigente en su lugar de residencia. Esto garantiza que los aparatos en desuso y sus embalajes se reciclan de forma profesional y evita consecuencias negativas para el medioambiente.



Deseche los materiales del embalaje por separado en los contenedores correspondientes. Deseche el cartón en el contenedor de papel y el plástico transparente en el contenedor de envases reciclables.
















¡No lo deseche con los residuos domésticos normales! La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE) requiere que este dispositivo eléctrico (incluidos todos sus accesorios y piezas) se deseche en un punto limpio o punto de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos. Esto evita la liberación de sustancias dañinas* al medio ambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

13. Etiquetado

Consulte la sección correspondiente en inglés.

14. Signos y símbolos

	Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente o un problema cuando se utiliza el dispositivo.
	Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente o un problema cuando se utiliza el dispositivo.
IP32	El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos de más de 2,5 mm de diámetro, como por ejemplo los dedos, como protección contra descargas eléctricas.
	No deseche el dispositivo junto con los residuos domésticos normales. Deséchelo de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente. En cumplimiento de la Directiva RAEE.
	Contiene ion-litio.
	La batería recargable integrada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Desechar según la normativa local.
	Pueden producirse interferencias en las cercanías del equipo.
	Grado de protección contra descargas eléctricas: parte aplicada al paciente de tipo BF.
	Fecha de fabricación.
	Fabricante.
	Número de serie del producto.
	Número de referencia de producto.
	Dispositivo médico.
	Lea el manual del usuario.

i Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire o con oxígeno u óxido nítrico.

15. Especificaciones

N.º de modelo	Pieza de mano: H2502 Accesorio de RF: HA2502
Zona de tratamiento	Pieza de mano: 426 mm ² Accesorio de RF: 1012 mm ² Accesorio de RF + Cabezal RF: 1438 mm ²
Tecnología	Home Technology™
Luz LED roja (longitud de onda; potencia de salida óptica)	Pieza de mano: 22±0,66 mW/cm ² Accesorio de RF: 20±0,6 mW/cm ²
Infrarrojo (longitud de onda; potencia de salida óptica)	Pieza de mano: 23±0,69 mW/cm ² Accesorio de RF: 18±0,54 mW/cm ²
Radiofrecuencia (RF) (frecuencia; potencia de salida máxima)	Pieza de mano: 1 MHz ±30%; 10W max Pieza de mano + Accesorio de RF: 1 MHz ±30%; 20W max
Funcionamiento y seguridad	Estabilizador del calor que evita el sobrecalentamiento de la piel
Dimensiones:	
Pieza de mano + Accesorio de RF	189 x 71 x 61 mm ²
Peso del sistema	
Pieza de mano; Accesorio de RF	210 gr; 45 gr
Tiempo desde la temperatura mínima de almacenamiento entre usos hasta alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 °C	30 minutos
Tiempo desde la temperatura máxima de almacenamiento entre usos hasta alcanzar la temperatura máxima de funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 °C	30 minutos
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: de -40 a 70 °C Humedad relativa: de 10 a 90 % Presión atmosférica: de 500 a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: de 10 a 35 °C Humedad relativa: de 30 a 75 % Presión atmosférica: de 700 a 1060 hPa
Adaptador de pared Entrada Salida Grado de protección	DZ024CHL120200H 100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A 12,0 V DC, 2,0 A, 24,0 W II
Este dispositivo ha sido probado y cumple con estos estándares.	CEI 60601-1-(seguridad) CEI 60601-2-2 (alta frecuencia) CEI 60601-1-2 (CEM) IEC 60601-1-11 (Medioambiente) IEC60601-2-83 (Seguridad de equipo de terapia de luz doméstico)

Vida útil prevista del equipo	5 años	
Batería recargable de ion-litio	Modelo:	INR21700-40T
	Tensión nominal:	3,7 V CD
	Capacidad nominal:	4000mAh

16. Curvas de potencia de salida

Consulte la sección correspondiente en inglés.

17. Resultados técnicos de CEM

Consulte la sección correspondiente en inglés.

18. Aviso legal

Copyright 2024 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Silk'n Beauty Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en sus especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Silk'n Beauty Ltd. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Silk'n Beauty Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente ni derechos de patente de Silk'n Beauty Ltd. No está permitido reproducir ni transmitir ninguna parte del presente documento en formato o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, para cualquier propósito sin el permiso expreso y por escrito de Silk'n Beauty Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Silk'n Beauty Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente contemplado en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd., Alon Ha-Tavor 15, Caesarea, 3079516, Israel, www.silkn.com, www.silkn.ca, info@silkn.com.



PB120112A

Issue date: 01/2024

Silk'n[®] Beauty

Manufacturer:

Silk'n Beauty Ltd, Alon Ha-Tavor 15,
Caesarea 3079516, Israel

www.silkn.com • www.silkn.ca • info@silkn.com

